

	<p>HySense® QL 2xx</p> <p>Hochpräziser Turbinen-Durchflusssensor mit ansteuerbaren Belastungsventil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatische Sensorerkennung ISDS • Ausgangssignal: Frequenz, Analog 4...20mA, CAN 	
<p>Beschreibung Description</p> <p>HySense QL 2xx ist ein hoch präziser Turbinen-Durchflusssensor zum Messen von Volumenstrom in statio-nären sowie mobilen Hydraulikanlagen mit ansteuerbaren Belastungsventil. Die Überprüfung von Pumpen, z.B. die Aufnahme der Kennlinie in Abhängigkeit vom Druck, wird durch den HySense QL 2xx deutlich vereinfacht. Ein ansteuerbares Proportionalventil simuliert eine nicht vorhandene Last. Speziell für die Druck- und Temperaturmes-sung sind zwei MINIMESS®-Testpunkte in dem Sensor vorinstal-liert, sodass Druck sowie Temperatursensoren ohne Anlagen-stillstand eingebaut und betrieben werden können. Die ISDS-Funktionalität realisiert eine automatische Sensorerkennung sowie Parametri-sierung in Hydrotechnik Messgeräten.</p> <p>Mögliche Ausgangssignale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frequenz (Rechtecksignal) • Analog (4...20mA) • CAN <p>In jedem Ausgangssignal ist die ISDS Funktionalität implementiert.</p>		

<p>Beschreibung Description</p> <p>HySense QL 2xx ist ein hoch präziser Turbinen-Durchflusssensor zum Messen von Volumenstrom in statio-nären sowie mobilen Hydraulikanlagen mit ansteuerbaren Belastungsventil. Die Überprüfung von Pumpen, z.B. die Aufnahme der Kennlinie in Abhängigkeit vom Druck, wird durch den HySense QL 2xx deutlich vereinfacht. Ein ansteuerbares Proportionalventil simuliert eine nicht vorhandene Last. Speziell für die Druck- und Temperaturmes-sung sind zwei MINIMESS®-Testpunkte in dem Sensor vorinstal-liert, sodass Druck sowie Temperatursensoren ohne Anlagen-stillstand eingebaut und betrieben werden können. Die ISDS-Funktionalität realisiert eine automatische Sensorerkennung sowie Parametri-sierung in Hydrotechnik Messgeräten.</p> <p>Mögliche Ausgangssignale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frequenz (Rechtecksignal) • Analog (4...20mA) • CAN <p>In jedem Ausgangssignal ist die ISDS Funktionalität implementiert.</p>	<p><i>The HySense QT 2xx is a high precision turbine flow meter with a controllable load valve which measures volumetric flow rate in stationary and mobile hydraulic equipment's. Testing of pumps, e.g. the recording of a characteristic curve in dependency of the pressure, is simplified significantly by using the HySense QT 2xx. A controllable proportional valve simulates a nonexistent load. Two MINIMESS®-test points are specially preassembled to allow both pressure and temperature sensors to be installed without shutting the equipment down. The ISDS- functionality realizes an automatic sensor identification and parameterization in hydrotechnical instruments.</i></p> <p><i>Available output signals:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Frequency • Analog (4...20mA) • CAN <p><i>The ISDS functionality is implemented in each output signal.</i></p>
---	---

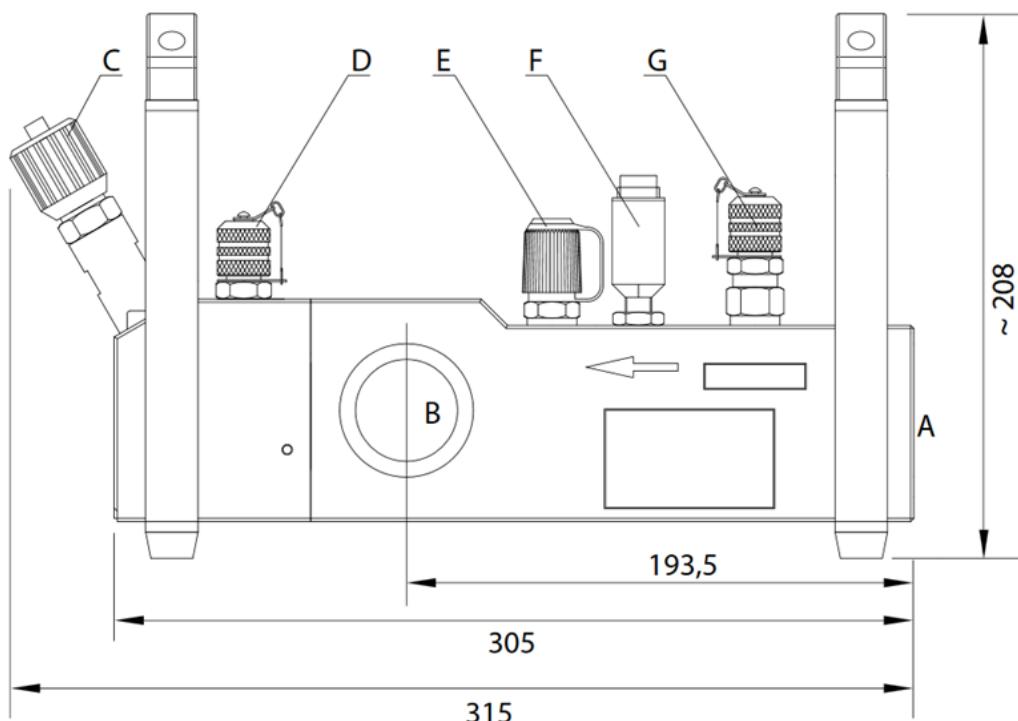
Funktionsprinzip <i>Operating principle</i>	<p>Das Turbinenlaufrad wird durch die Strömungsenergie des durchströmenden Mediums in Rotation versetzt. Dabei ist die Laufradfrequenz annähernd proportional zur mittleren Strömungsgeschwindigkeit (über dem Rohrquerschnitt). Resultierend daraus ist der Volumenstrom ebenfalls annähernd proportional zur Laufradfrequenz. Diese wird durch einen externen Sensor detektiert, verarbeitet und ausgegeben. Das vorgesteuerte Hand-Drosselventil steuert den Ventileinsatz und die Drosselung des Volumenstromes durch die Belastungsstrecke.</p>	<p>The turbine wheel is set in rotation by the flow energy of the medium. The turbine frequency is approximately proportional to the flow velocities, resulting that the flow rate is also approximately proportional to the turbine frequency. This frequency is detected, processed and delivered by the pickup. The pilot operated manual throttle valve controls the valve insert and the throttling of the volume flow through the load path.</p>
Verwendungszweck <i>Desgnated use</i>	<p>Zur Simulation von hydraulischen Lasten, z.B. die Aufnahme einer Pumpenkennlinie in Abhängigkeit vom Druck, in stationären sowie mobilen Hydraulikanlagen. Verwendung in Hydraulik und der Ölindustrie mit Flüssigkeiten der Gruppe 2 gemäß Klassifizierung der Druckgeräterichtlinie 2014/68/ EU (ungefährliche Fluide). Prädestiniert für Hydrauliköle sowie Öle auf Mineralölbasis. Nicht für den Einsatz in Wasser oder Gasen geeignet. Das System darf nicht zu Steuer- und Regelzwecken eingesetzt werden.</p>	<p><i>For simulation of hydraulic loads, e.g. the recording of a pump characteristic curve in dependency of the pressure, in stationary and mobile hydraulic systems. Use in hydraulic and oil industry. Use only in liquids of group 2 according to the classification of the pressure equipment directive 2014/68/EU (non-dangerous fluids). Predestinated for hydraulic oils and mineral oil based liquids. Not suitable for water or gases. It is not allowed to use the system as control unit.</i></p>
Gebrauchshinweise <i>Note for use</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Jegliche Anwendung außerhalb der technischen Spezifikationen sind nicht zulässig • Nicht mit Wasser, Luft oder Gasen verwenden • Es dürfen sich keine Luftblasen im Hydrauliksystem befinden • Druckschläge vermeiden • Schnellen Richtungswechsel des Messmediums vermeiden • Nicht mit Pressluft ausblasen • Am Ausgang muss der relative Systemdruck ≥ 1 bar sein • Viskositätsabweichung von der Kaliberviskosität verschlechtert die Messgenauigkeit deutlich 	<ul style="list-style-type: none"> • Any application out of the technical specification aren't allowed • Do not use with water, air or gas • No air bubbles in the hydraulic system • Avoid pressure shocks • Avoid rapid changes in direction of the medium • Don't clean with compressed air • The relative system pressure must be ≥ 14.5 psi in the output • Viscosity deviation from the calibration viscosity reduce the measurement accuracy significantly

Sicherheitshinweis Note on safety	Die erforderliche Druckabsicherung muss kundenseitig erfolgen, z.B. durch den Einbau eines Druckbegrenzungsventils vor dem HySense QL 2xx oder über das vorgesetzte Hydrauliksystem.	<i>The user is responsible for a suitable high pressure protection, e.g. by installing a pressure protection valve in front of the HySense QL 2xx or by the hydraulic system itself.</i>
--	--	--

Hinweis zum Datenblatt Notes to data sheet	Teil 1 dieses Datenblatts enthält Angaben, die für die gesamte Produktreihe HySense QL 2xx zu treffen. Teil 2 listet die für das jeweilige Ausgangssignal gültigen Eigenschaften auf.	Part 1 of the data sheet includes common technical data for the complete HySense QL 2xx series. Finally, part 2 lists the parameters for different output signals.
---	---	--

Teil 1 Part 1	Allgemeine Angaben zur Produktserie Common features for the product series		
--------------------------------	---	--	--

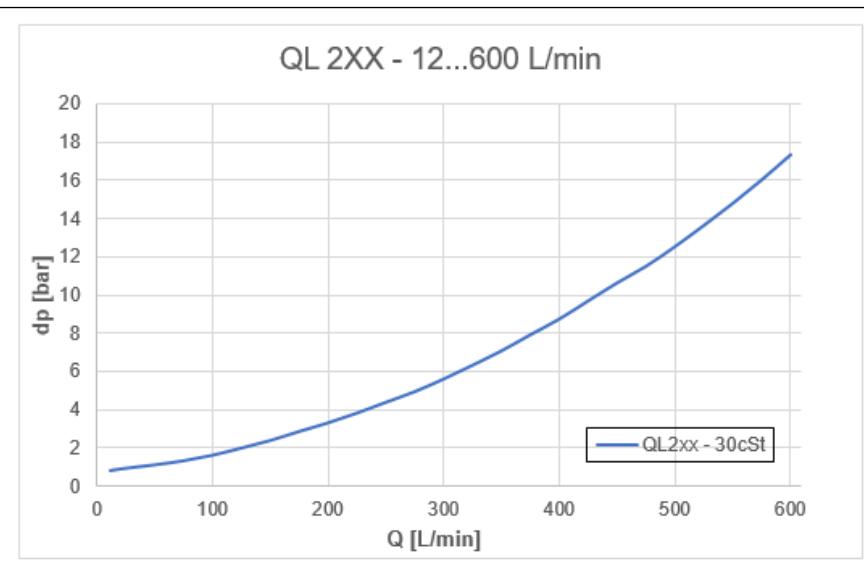
Eigenschaften Properties			
Parameter	Größe <i>Dimensions</i>	Einheit <i>Units</i>	Bemerkung <i>Remarks</i>
Ansprechzeit <i>Response time</i>	< 0.05	s	
Viskositätsbereich <i>Viscosity range</i>	5...100	cSt mm ² /s	Höhere Viskositäten auf Anfrage <i>Higher viscosities on request</i>
Standard Kalibrierviskosität <i>Standard calibration viscosity</i>	30	cSt mm ² /s	
Mediumtemperatur <i>Medium temperature</i>	-20...100 -4...185	°C °F	
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature</i>	-20...85 -4...185	°C °F	
Lagertemperatur <i>Storage temperature</i>	-20...85 -4...185	°C °F	
Belastungsstreckengehäuse <i>Loading valve housing</i>	Aluminiumlegierung anodisiert Aluminium alloy anodized	EN AW 7075 / DIN 30645	
Innenteile <i>Internal parts</i>	Aluminiumlegierung anodisiert / Automatenstahl brüniert Aluminium alloy anodized / Free cutting steel burnished	EN AW 6026LF / DIN 30645 1.0715 / DIN 50983	
Aufnehmergehäuse <i>Sensor housing</i>	Aluminiumlegierung anodisiert Aluminium alloy anodized	EN AW 2007 / DIN 30645	
Dichtungsmaterial <i>Sealing material</i>	FKM	Andere auf Anfrage <i>Others on request</i>	
Medienverträglichkeit <i>Fluid compatibility</i>	Hydrauliköle, Öle auf Mineralölbasis Hydraulic oils, mineral oil based fluids	Andere auf Anfrage <i>Others on request</i>	
IP-Schutz <i>Protection</i>	IP 67	Gilt für alle Aufnehmer <i>Applies to all Pick-Ups</i>	

Baugruppen-Zeichnung
Assembly drawing


Kürzel <i>Contraction</i>	Bezeichnung
A	Anschluss Einlauf / <i>connection entry</i>
B	Anschluss Auslauf / <i>connection outlet</i>
C	Drosselventil für kontinuierliche Druckeinstellungen / <i>throttle valve für continues pressure settings</i>
D	Minimess® Messkupplung für Entlüftung, 1620 / <i>Minimess® test point for venting, 1620</i>
E	Minimess® Messkupplung, 1620 / <i>Minimess® test point, 1620</i>
F	Induktivaufnehmer / <i>inductive pickup</i>
G	Minimess® p/T-Messkupplung, 1620 / <i>Minimess® p/T- test point</i>

Baugröße und Eigenschaften
Design size and specifications

Baugröße <i>Size</i>	Anschlussgewinde <i>Connection size</i>	Max. Druck <i>Max. pressure</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Breite <i>Width</i>
	[ISO 228]	[bar]	[psi]	[mm]
QL 2xx 600 L/min	G1 1/4	350	5000	ca. 6520
				85

Differenzdruck
Pressure difference

Einbauhinweise
Installation instructions

- Einbaulage beliebig, standardmäßige Strömung in Pfeilrichtung
- Vor dem Einbau Anlage von Verunreinigungen befreien
- Keine Schmutzpartikel >25µm im Messfluid
- Nach dem Einbau langsam mit Betriebsmittel füllen und Leitungen entlüften
- Starke Querschnittsänderungen in der Einlaufstrecke vermeiden
- Empfohlene gerade Einlaufstrecke vor der Messturbine ist 30 x Nenn durchmesser
- Any mounting position possible, standard flow in direction of arrow
- Before mounting, clean the system by thoroughly rinsing of contaminants
- No particles > 25µm in the fluid
- After mounting, please fill slowly with the operating medium and vent the pipes
- Avoid strong cross-sectional changes in the inlet zone
- Recommended straight inlet zone of the turbine is 30 x nominal diameter

Anzugsmomente (Toleranz +10%, Edelstahlgewinde schmieren)
Recommended tightening torque (tolerance +10%, thread lubricated)

ISO 228-G1 1/4	385 Nm
MINIMESS® ISO228-G 1/4 <i>Torque MINIMESS®/ISO228-G 1/4</i>	40 Nm
MINIMESS® 7/16-20 UNF (ANSI B1.1) <i>Torque MINIMESS®7/16-20 UNF (ANSI B1.1)</i>	30 Nm
Signalauftnehmer <i>Torque sensor nut</i>	10 Nm

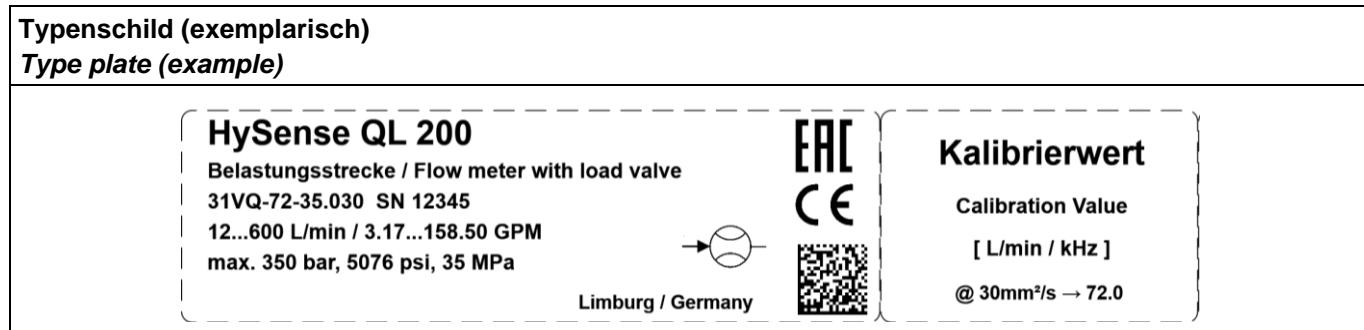
Typenschlüssel für Turbinen Volumendurchflusssensoren QL 2xx
Type code for turbine flow meter QL 2xx

Bestellbeispiel:

How to order:

3	1	V	Q	-	72	-	3	5	.	030	
Messgeräte / Sensorik allgemein / Instruments / Sensors general	Aufnehmer / sensor	Serie / series	Anschlussgewinde / Durchflussbereich connecting thread / flow range				Bestückung Pos.1 mounting Pos.1	Bestückung Pos.2 mounting Pos.2		Kalibrierviskosität calibration viscosity	
Medienverträglichkeit / Medium compatibility							5	p/T-Messkupplung Reihe 1620 (Kennzahl 04)			
							6	p/T-Messkupplung Reihe 1615 (Kennzahl 04)			
					72	ISO 228-G1½	2	Schraubkupplung Reihe 1615, Kunststoffkappe			
							3	Schraubkupplung Reihe 1620, Kunststoffkappe			
									12...600 L/min		
		Q	QL 2xx								
	C	QL 206 CAN, elektr. Anschluss M12, 5-pol.									
	I	QL 210 Analog 4...20mA, elektr. Anschluss M12, 4-pol., ISDS									
	J	QL 210 Analog 4...20mA, elektr. Anschluss M16, 6-pol., ISDS									
	K	QL 200 Frequenz, elektr. Anschluss M12, 4-pol., ISDS									
	V	QL 200 Frequenz, elektr. Anschluss M16, 6-pol., ISDS									
	1	Hydrauliköle und Öle auf Mineralölbasis									
	A	Skydrol (auf Anfrage / on request)									
3											

Typenschild (exemplarisch)
Type plate (example)



TKZ <i>Order number</i>	Zubehör und Ersatzteile <i>Accessories and spare parts</i>
8824-S1-xx.xxS ¹	Messkabel, Frequenz, 4...20mA, M16 6-pol. Stecker – M16 6-pol. Buchse <i>measuring cable frequency, 4...20mA, M16 6-pole connector – 6-pole M16 socket</i>
8824-S1-xx.xxH ¹	Messkabel, Frequenz, 4...20mA, ISDS, M16 6-pol. Stecker – M16 6-pol. Buchse (High End) <i>measuring cable frequency, 4...20mA, M16 6-pole connector – 6-pole M16 socket (High End)</i>
8824-S6-xx.xxS ¹	Messkabel, Frequenz, 4...20mA, M16 6-pol. Stecker – offenes Kabelende <i>measuring cable frequency, 4...20mA, M16 6-pole connector – open cable end</i>
8824-S6-xx.xxH ¹	Messkabel, Frequenz, 4...20mA, ISDS, M16 6-pol. Stecker – offenes Kabelende (High End) <i>measuring cable frequency, 4...20mA, M16 6-pole connector – open cable end (High End)</i>
8824-S2-xx.xxS ²	Adapterkabel, Frequenz, 4...20mA, M16 5-pol. Stecker – M16 6-pol. Buchse <i>adapter cable frequency, 4...20mA, M16 5-pole connector – 6-pole M16 socket</i>
8824-S2-xx.xxH ²	Adapterkabel, Frequenz, 4...20mA, ISDS, M16 5-pol. Stecker – M16 6-pol. Buchse (High End) <i>adapter cable frequency, 4...20mA, M16 5-pole connector – 6-pole M16 socket (High End)</i>
8824-S3-xx.xxS ³	Verlängerungskabel, Frequenz, 4...20mA, M16 6-pol. Stecker – M16 6-pol. Buchse <i>extension cable frequency, 4...20mA, M16 6-pole connector – 6-pole M16 socket</i>
8824-S3-xx.xxH ³	Verlängerungskabel, Frequenz, 4...20mA, M16 6-pol. Stecker – M16 6-pol. Buchse (High End) <i>extension cable frequency, 4...20mA, M16 6-pole connector – 6-pole M16 socket (High End)</i>
8824-N3-xx.xx ⁴	Messkabel CAN, M12 5-pol. Stecker – M12 5-pol. Buchse <i>measuring cable CAN, M12 5-pole connector – M12 5-pole socket</i>
8824-R7-xx.xx ⁴	Messkabel CAN, M12 8-pol. Stecker – M12 5-pol. Buchse <i>measuring cable CAN, M12 8-pole connector – M12 5-pole socket</i>
8824-T6-xx.xx ⁴	Messkabel CAN, M12 8-pol. Stecker – M12 8-pol. Buchse <i>measuring cable CAN, M12 8-pole connector – M12 8-pole socket</i>
8824-L0-xx.xx ⁴	Messkabel CAN, M12 5-pol. Buchse – offenes Kabelende <i>measuring cable CAN, M12 5-pole socket – open cable end</i>
8824-T1-xx.xx ⁴	Messkabel CAN, M12 8-pol. Buchse – offenes Kabelende <i>measuring cable CAN, M12 8-pole socket – open cable end</i>
8824-V1-02.50	Messkabel, Frequenz, 4...20mA, M12 4-pol. Stecker – offenes Kabelende <i>measuring cable frequency, 4...20mA, M12 4-pole connector – open cable end</i>
8824-V3-02.50S	Messkabel, Frequenz, 4...20mA, M16 6-pol. Stecker – M12 4-pol. Buchse (Standard) <i>measuring cable frequency, 4...20mA, M16 6-pole connector – 4-pole M12 socket (Standard)</i>
8824-V3-02.50H	Messkabel, Frequenz, 4...20mA, M16 6-pol. Stecker – M12 4-pol. Buchse (High End) <i>measuring cable frequency, 4...20mA, M16 6-pole connector – 4-pole M12 socket (High End)</i>

¹ Verfügbare Standardlängen: 02.50 = 2,5m; 05.00 = 5,0m; 10.00 = 10,0m. Available standard lenghts: 02.50 = 2,5m; 05.00 = 5,0m; 10.00 = 10,0m.

² Verfügbare Standardlängen: 00.30 = 0,3m; 02.50 = 2,5m; 05.00 = 5,0m; 10.00 = 10,0m. Available standard lenghts: 00.30 = 0,3m; 02.50 = 2,5m; 05.00 = 5,0m; 10.00 = 10,0m.

³ Verfügbare Standardlängen: 02.50 = 2,5m; 05.00 = 5m. Available standard lenghts: 02.50 = 2,5m; 05.00 = 5m.

⁴ Verfügbare Standardlängen: 02.50 = 2,5m; 05.00 = 5m. Available standard lenghts: 02.50 = 2,5m; 05.00 = 5m.

TKZ <i>Order number</i>	Zubehör und Ersatzteile <i>Accessories and spare parts</i>
2149-04-15.53N	p/T MINIMESS®-Testpunkt (FKM), ISO 228 G1/4", <i>Stahl</i> <i>p/T MINIMESS®-test point (FKM)</i> , ISO 228 G1/4", <i>steel</i>
2749-04-15.53	p/T MINIMESS®-Testpunkt (FKM), ISO 228 G1/4", <i>Edelstahl</i> <i>p/T MINIMESS®-test point (FKM)</i> , ISO 228 G1/4", <i>stainless steel</i>
2103-01-18.10N	MINIMESS®-Testpunkt (FKM), ISO 228 G1/4", <i>Stahl</i> <i>MINIMESS®-test point (FKM)</i> , ISO 228 G1/4", <i>steel</i>
2703-01-18.10	MINIMESS®-Testpunkt (FKM), ISO 228 G1/4", <i>Edelstahl</i> <i>MINIMESS®-test point (FKM)</i> , ISO 228 G1/4", <i>stainless steel</i>
3410-16P0-A233F03 ⁵	HySense RS 500, Frequenz, M16 6-pol. Stecker <i>HySense RS 500, frequency, M16 6-pol. connector</i>
3410-16P0-A211F07 ⁵	HySense RS 500, Frequenz, M12 4-pol. Stecker <i>HySense RS 500, frequency, M12 4-pol. connector</i>
3410-14P0-A233Z1S ⁵	HySense RS 510, analog 4...20mA, M16 6-pol. Stecker <i>HySense RS 510, analog 4...20mA, M16 6-pol. connector</i>
3410-14P0-A211Z13 ⁵	HySense RS 510, analog 4...20mA, M12 4-pol. Stecker <i>HySense RS 510, analog 4...20mA, M12 4-pol. connector</i>
3410-14P0-A213C11 ⁵	HySense RS 506, CAN, M12 5-pol. Stecker <i>HySense RS 506, CAN, M12 5-pol. connector</i>

Rekalibrierung von Volumendurchflusssensoren**Recalibration from flow sensors**

Jeder Volumendurchflusssensor besitzt eine individuelle Messcharakteristik, welche selbst bei gleichen Sensor-typen sowie -größen variiert. Grund hierfür sind die mechanischen Fertigungstoleranzen, die massiven Einfluss auf die Messcharakteristik haben. Resultierend daraus muss jeder neue Sensor kalibriert und justiert werden, um eine spezifizierte Messperformance sicherzustellen. Wird ein Sensor im Feld betrieben, erfolgt in Abhängigkeit der Betriebsart und der Betriebsbedingungen eine zeitliche Änderung der Messcharakteristik. Diese Veränderung resultiert aus Überlastbetrieb, Ablagerungen, Kontaminierung, Alterung sowie Änderung der Medieneigenschaften. Die Veränderung der Messcharakteristik kann sich negativ auf die Messperformance auswirken. Dies kann nicht im Vorfeld prognostiziert werden und ist vom jeweiligen Einsatzfall abhängig. Infolgedessen sollte jeder Sensor in bestimmten Intervallen rekaliert werden, um diese Veränderung festzustellen und ggf. zu kompensieren.

Each volume flow sensor has an individual measuring characteristic which varies even with the same sensor types and sizes. The reason for this is the mechanical manufacturing tolerances, which have a massive influence on the measurement characteristics. As a result, each new sensor must be calibrated and adjusted to ensure a specified measurement performance. When a sensor is operated in the field, the measurement characteristics change over time depending on the operating mode and operating conditions. This change results from overload operation, deposits, contamination, ageing and changes in media properties. The change in the measurement characteristic can have a negative effect on the measurement performance. This cannot be predicted in advance and depends on the specific application. Consequently, each sensor should be recalibrated at certain intervals to detect and, if necessary, compensate for this change.

⁵ Bei der Bestellung dieses Teiles wird die Seriennummer des alten Aufnehmers oder des zugehörigen Volumenstromsensor benötigt.
The serial number of the old transducer or the associated volumetric flow sensor is required when you ordering this part.

<p>Wir empfehlen folgende Kalibrierintervalle, falls keine Erfahrungswerte vorliegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laboreinsatz (temp. Einsatz als Mastergeber mit geringer Einsatzdauer) → 36 Monate • Standardgebrauch (temp. Einsatz bei Teillast) → 24 Monate • Erhöhte Belastung (station. Einsatz bei Teillast) → 12 Monate • Extreme Belastung (station. Einsatz bei Volllast) → 6 Monate 	<p>We recommend the following calibration intervals, if no empirical data are available.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laboratory application (temporary use as a master encoder with a short operating time) → 36 months • Standard use (temporary use with partial load) → 24 months • Increased load (stationary use with partial load) → 12 months • Extreme load (steady load at full load) → 6 months
--	--

Umrechnung, Durchfluss ↔ Strom Conversion, flow rate ↔ current	
Durchfluss → Strom <i>flow rate → current</i>	Strom → Durchfluss <i>current → flow rate</i>
$I(Q_{\text{read}}) = \frac{16 \text{ mA} \cdot Q_{\text{read}}}{Q_{\text{max}}} + 4 \text{ mA}$	$Q(I_{\text{read}}) = \frac{Q_{\text{max}} \cdot (I_{\text{read}} - 4 \text{ mA})}{16 \text{ mA}}$



Europäische Konformität European Conformity		
Elektromagnetische Verträglichkeit / <i>electromagnetic compatibility</i>	Richtlinie 2004/108/EG	Directive 2004/108/EG
Druckgeräte / <i>pressure equipment</i>	Richtlinie 2014/68/EU	Directive 2014/68/EU
Beschränkung gefährlicher Stoffe / <i>Restriction of Hazardous Substances Directive</i>	Richtlinie 2011/65/EU	Directive 2011/65/EU

REACH-Regulation (EU) No.1907/2006, Art. 33	<p>Die HYDROTECHNIK GmbH ist als Hersteller von Erzeugnissen, im Sinne der REACH-Verordnung, nachgeschalteter Anwender geringer Mengen und somit nicht registriertspflichtig.</p> <p>Gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung informieren wir Sie hiermit, dass von uns gelieferte Produkte aus Automatenstahl bis zu 0,35% Massenprozent Blei enthalten können.</p> <p>Außer diesem beinhalten unsere Produkte keine weiteren Stoffe der derzeitigen REACH-Kandidatenliste (SVHC).</p>	<p><i>HYDROTECHNIK GmbH as a manufacturer of products is, with regard to the REACH regulation, a downstream-user of small quantities. As such it is not obliged to register.</i></p> <p><i>In accordance with Article 33 of the REACH Regulation, we hereby inform you that products made of free cutting steel supplied by us can contain up to 0.35% percent by weight lead.</i></p> <p><i>Apart from this, our products do not contain other substances from the current REACH Candidate List (SVHC).</i></p>
--	--	--

Haftungsausschuss Limitation of Liability	<p>Die genannten technischen Daten werden unter Laborbedingungen ermittelt. Hierbei werden die aktuell gültigen Normen zugrunde gelegt, sofern zutreffend. Für nicht durch Normierung definierte Eigenschaften werden in Anlehnung an Normen für verwandte Produkte eigene Testkriterien definiert. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert.</p> <p>Die Produkte dürfen nur ihrer Bestimmung gemäß verwendet werden. Die Prüfung der Eignung für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck bzw. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen, obliegt dem Auftraggeber; hierfür übernimmt die HYDRO-TECHNIK GmbH keine Gewährleistung.</p> <p>Änderungen an Produkten und Dokumentationen im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung sind vorbehalten und können jederzeit ohne vorherige Mitteilung eintreten. Die dann gültigen Spezifikationen können von den Angaben in dieser Revision des technischen Datenblatts abweichen. Druckfehler sind vorbehalten. Im Zweifelsfall gilt die deutsche Sprachversion.</p>	<p><i>The technical data listed were determined under laboratory conditions. Test criteria were defined in accordance to currently valid norms, as far as available. For properties, which are not defined in any norm for the given product, test criteria are based on norms for similar products. Any liability is limited accordingly.</i></p> <p><i>All of the devices and components listed may be used for their intended purpose only. It remains to the customer's responsibility to qualify whether the device is suitable for the customer's intended purpose and the intended conditions of use or not; we do not assume any liability in this respect.</i></p> <p><i>Changes of products and documentation in the sense of technical progress and continuous improvement may occur at any time without prior notification. Hence specifications may than differ from those given in this revision of the technical data sheet.</i></p> <p><i>There is no liability for possible misprints.</i></p> <p><i>The German language version is valid in any case of doubt.</i></p>
--	---	--

Teil 2
Part 2Eigenschaften nach Ausgangssignal
Parameters for output signal

Frequenz

Pinbelegungen Pin assignments	Bezeichnung Labeling	Nr. No	Funktion Function	Function																								
Rundsteckverbinder M16 x 0.75 mit Schraubverriegelung, Ausführung 06-a, 6-polig, Stecker Circular connectors M16 x 0.75 with screw-locking Layout 06-a, 6 poles, male IEC / DIN EN 61076-2-106																												
 QL 200 Frequenz / Frequency <table> <tr> <td>f-Signal</td> <td>1</td> <td>Frequenzsignal</td> <td>Frequency signal</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td>2</td> <td>Masse</td> <td>Ground</td> </tr> <tr> <td>+Ub</td> <td>3</td> <td>Versorgungsspannung</td> <td>Supply voltage</td> </tr> <tr> <td>NC</td> <td>4</td> <td>nicht verbunden</td> <td>not connected</td> </tr> <tr> <td>NC</td> <td>5</td> <td>nicht verbunden</td> <td>not connected</td> </tr> <tr> <td>ISDS</td> <td>6</td> <td>Sensorerkennung</td> <td>Sensor detection</td> </tr> </table>					f-Signal	1	Frequenzsignal	Frequency signal	GND	2	Masse	Ground	+Ub	3	Versorgungsspannung	Supply voltage	NC	4	nicht verbunden	not connected	NC	5	nicht verbunden	not connected	ISDS	6	Sensorerkennung	Sensor detection
f-Signal	1	Frequenzsignal	Frequency signal																									
GND	2	Masse	Ground																									
+Ub	3	Versorgungsspannung	Supply voltage																									
NC	4	nicht verbunden	not connected																									
NC	5	nicht verbunden	not connected																									
ISDS	6	Sensorerkennung	Sensor detection																									
Rundsteckverbinder M12 x 1 mit Schraubverriegelung A-Kodierung, 4-polig, Stecker IEC / DIN EN 61076-2-101 Circular connectors M12 x 1 with screw-locking A-coding, 4 poles, male IEC / DIN EN 61076-2-101																												
 QL 200 Frequenz / Frequency <table> <tr> <td>+Ub</td> <td>1</td> <td>Versorgungsspannung</td> <td>Supply voltage</td> </tr> <tr> <td>ISDS</td> <td>2</td> <td>Sensorerkennung</td> <td>Sensor detection</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td>3</td> <td>Masse</td> <td>Ground</td> </tr> <tr> <td>f-Signal</td> <td>4</td> <td>Frequenzsignal</td> <td>Frequency signal</td> </tr> </table>					+Ub	1	Versorgungsspannung	Supply voltage	ISDS	2	Sensorerkennung	Sensor detection	GND	3	Masse	Ground	f-Signal	4	Frequenzsignal	Frequency signal								
+Ub	1	Versorgungsspannung	Supply voltage																									
ISDS	2	Sensorerkennung	Sensor detection																									
GND	3	Masse	Ground																									
f-Signal	4	Frequenzsignal	Frequency signal																									

Messgenauigkeit mit ISDS oder Linearisierung

Accuracy with ISDS or linearisation


Kalibrierter Bereich Calibrated range				Messgenauigkeit Accuracy
L/min				%
12	600	4.2	160	± 0.5 vom Messwert / of reading

Messgenauigkeit ohne Linearisierung

Accuracy without linearisation

Kalibrierter Bereich Calibrated range				Messgenauigkeit Accuracy
L/min				%
25	600	6.6	160	± 2.5 vom Messwert / of reading



CAN

Pinbelegungen <i>Pin assignments</i>	Bezeichnung <i>Labeling</i>	Nr. <i>No</i>	Funktion <i>Function</i>	<i>Function</i>
Rundsteckverbinder M12 x 1 mit Schraubverriegelung A-Kodierung, 5-polig, Stecker IEC / DIN EN 61076-2-101 <i>Circular connectors M12 x 1 with screw-locking A-coding, 5 poles, male IEC / DIN EN 61076-2-101</i>				
 QT 506 CAN				
CAN SHLD	1	CAN Schirm	CAN Shield	
CAN V+	2	CAN Versorgung	CAN Supply	
CAN GND	3	CAN Masse	CAN Ground	
CAN H	4	CAN High	CAN High	
CAN L	5	CAN Low	CAN Low	

Messgenauigkeit <i>Accuracy</i>		Kalibrierter Bereich <i>Calibrated range</i>		Messgenauigkeit <i>Accuracy</i>
L/min		GPM		%
12	600	4.227	158.504	± 0.5 vom Messwert / <i>of reading</i>

CANopen Parameter					
Übertragungsrate / <i>transfer rate</i>	20		1000	kBit/s	
PDO / <i>process data object</i>		1			
Knoten Nr. / <i>Node Id.</i>		10			(hex = 0xA)
COB ID PDO1		394			(hex = 0x18A)
Senderate / <i>sending rate</i>	10		1000	ms	
Geräte Status / <i>node state</i>		pre-operational			
Prozessdaten: <i>process data</i>					
Frequenz / <i>frequency</i>		fx1000		Hz	
Signaltyp / <i>value type</i>		ulong		Bytes	Byte [0...3]
Beispiel / <i>example</i>					1kHz => 0x000F4240
Volumenstrom / <i>flow rate</i>		Qx1000		l/min	alternativ gal / min
Signaltyp / <i>value type</i>		ulong		Bytes	Byte [4...7]
Beispiel / <i>example</i>					200l/min => 0x00030D40

Analog 4...20mA

Pinbelegungen Pin assignments	Bezeichnung Labeling	Nr. No	Funktion	Function
Rundsteckverbinder M16 x 0.75 mit Schraubverriegelung, Ausführung 06-a, 6-polig, Stecker <i>Circular connectors M16 x 0.75 with screw-locking Layout 06-a, 6 poles, male IEC / DIN EN 61076-2-106</i>				
	QL 210 4...20 mA 2-Draht / 2-wire			
	Signal	1	Signal	Signal
	ISDS GND ⁶	2	Masse	Ground
	+Ub	3	Versorgungsspannung	Supply voltage
	NC	4	nicht verbunden	not connected
	NC	5	nicht verbunden	not connected
	ISDS	6	Sensorerkennung	Sensor detection
Rundsteckverbinder M12 x 1 mit Schraubverriegelung A-Kodierung, 4-polig, Stecker IEC / DIN EN 61076-2-101 <i>Circular connectors M12 x 1 with screw-locking A-coding, 4 poles, male IEC / DIN EN 61076-2-101</i>				
	QL 210 4...20 mA 2-Draht / 2-wire			
	+Ub	1	Versorgungsspannung	Supply voltage
	ISDS	2	Sensorerkennung	Sensor detection
	Signal	3	Signal	Signal
	ISDS GND ⁶	4	Masse	Ground

Messgenauigkeit Accuracy		Kalibrierter Bereich <i>Calibrated range</i>		Messgenauigkeit Accuracy
L/min		GPM		%
12	600	4.227	158.504	± 0.5 vom Messwert / of reading zzgl. / plus ± 0.1 vom Endwert / of full scale

⁶ Der Masse-Anschluss bei QL210 bezieht sich ausschließlich auf die ISDS-Kommunikation.
Ground pin of QL210 referring to ISDS communication exclusively.